



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง
เลขที่ B๑๖๗/๒๕๖๑
(เลขที่โครงการ ๖๑๐๕๗๒๓๗๗๗๔)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ตามประกาศเลขที่ B๑๖๗(ก)/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคตามประกาศ ทั้ง ๒ ราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายจรงค์ Wachirintorn)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๒๐๐-๔๕ ภายใน ๔๓๐๗-๙

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕/๒๗๘๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๑) เรียน รักษาการแทนอธิการบดี

ตามที่ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชื่อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณจาก งบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ B๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และได้ตรวจสอบระบบ มีผู้รับประกาศ จำนวน ๒ ราย พร้อมจัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท เอสพีแอล กรุป จำกัด
๒. บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ ราย ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมผ่านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิครายละเอียดข้อกำหนดแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคตามประกาศ ทั้ง ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท เอสพีแอล กรุป จำกัด เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศเลขที่เลขที่ B๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- มหาวิทยาลัยฯ กำหนดรายละเอียด ข้อ ๒.๑ เครื่องดมยาสลบ

๑. โครงสร้างประกอบด้วยโลหะพิเศษที่ไม่มีผลต่อการสนองต่อสนามแม่เหล็ก (Non Ferrous Materials) พร้อมลิ้นชักเก็บของ ๑ ลิ้นชัก มีสวิทช์ปิด-เปิดการทำงานของเครื่องดมยาสลบอยู่ด้านหน้า และมีคานสำหรับเท้าเหยียบเพื่อล็อกล้อด้านหน้า ๒ ล้อได้
๒. มีหน้าปิดบดแรงดันก๊าซ บริเวณด้านหน้าของเครื่องดมยาสลบมองเห็นได้ชัดเจนโดยแยกก๊าซแต่ละชนิดและสัญลักษณ์สี (Colour Code) กำกับ พร้อมแยกแรงดันก๊าซจากท่อส่งก๊าซ (Pipeline) หรือจากถังก๊าซให้เห็นอย่างชัดเจน


๓. มีปุ่มกดสำหรับให้ออกซิเจนฉุกเฉิน (O₂ Flush Valve)
๔. ตลอดแนวตั้งตรงด้านข้างทั้งสองของเครื่องดมยาสลบ มีรางยึดติดอุปกรณ์ต่าง ๆ
๕. มีระบบปิดการไหลของก๊าซไนตรัสออกไซด์ (Shut Off Nitrus) เมื่อความดันของก๊าซออกซิเจนต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โดยมีเสียงสัญญาณเตือน
๖. มีที่สำหรับแขวนเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ (Vaporizer) ได้ ๒ ตัว ในแนวเดียวกัน
- บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จำกัด แคนด้าล็อกที่เสนอไม่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะดังกล่าว
- มหาวิทยาลัยฯ กำหนดรายละเอียด ข้อ ๒.๒ เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซ (Flow Meter)
- (๓) ปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐.๐๕ - ๑๕ ลิตรต่อนาที แบ่งการวัดเป็น ๒ ส่วน คือ ๐.๐๕ - ๐.๙๕ ลิตรต่อนาที และ ๑ - ๑๕ ลิตรต่อนาที
- บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จำกัด เสนอปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐.๑ - ๑๐ ลิตรต่อนาที แบ่งการวัดเป็น ๒ ส่วน คือ ๐.๑-๐.๙๕ ลิตรต่อนาที และ ๑ - ๑๐ ลิตรต่อนาที ซึ่งไม่ตรงต่อข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ


๒. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศเลขที่เลขที่ B๑๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดรายละเอียด


- ข้อ ๒.๒ เครื่องปรับอัตราการไหลของก๊าซ (Flow Meter)
- (๓) ปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐.๐๕ - ๑๕ ลิตรต่อนาที แบ่งการวัดเป็น ๒ ส่วน คือ ๐.๐๕ - ๐.๙๕ ลิตรต่อนาที และ ๑ - ๑๕ ลิตรต่อนาที
- บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เสนอปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๐.๑ - ๑๐ ลิตรต่อนาที แบ่งการวัดเป็น ๒ ส่วน คือ ๐.๑-๐.๙๕ ลิตรต่อนาที และ ๑ - ๑๐ ลิตรต่อนาที ซึ่งไม่ตรงต่อข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ


คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการพิจารณาเบื้องต้น

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายวันชาติ ยิบประดิษฐ์)

ลงชื่อ..... .....กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นายณัฐ ด่านพ้าง)

ลงชื่อ..... .....กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางสาวปาริชาติ ตะโลกกลาง)


ลงชื่อ..... .....กรรมการและเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางสมพิศ ชยันโต)

ลงชื่อ..... .....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการพิจารณาผลประกวดราคาฯ
(นางสาวรินทร์ภัส นามาบ)


๑) เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
โปรดทราบเพื่อทราบ
พร้อมทั้งดำเนินการต่อไป

๑๐๐,๐๐๐


๗ มิ.ย. ๖๑


๕) อนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ ๔)



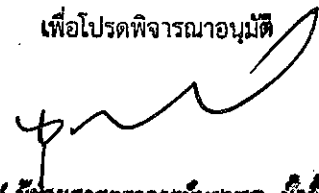
(นายจงรัก จักรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕) เงิน รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอรักษาการแทน
อธิการบดีอนุมัติ


- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

๔) เงิน รักษาการแทนอธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยามาศ มีศิริ)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑